

BG: WATRIUS – РЪКОВОДСТВО ЗА УПОТРЕБА

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Преносимият тестер E-2 TDS & EC е професионално мултифункционално устройство, предназначено за измерване на:

- **TDS (общо количество разтворени вещества)** във вода (mg/L или ppm)
- **Електропроводимост** ($\mu\text{S}/\text{cm}$)
- **Температура** ($^{\circ}\text{C}$ / $^{\circ}\text{F}$)

Устройството предлага висока производителност, дизайн тип писалка, бърза стабилизация на измерванията и точни резултати.

Обхват на измерване

- **Електропроводимост:** 0 – 9999 $\mu\text{S}/\text{cm}$
- **TDS:** 0 – 9999 ppm
- **Температура (Целзий):** 0,1 – 80,0 $^{\circ}\text{C}$
- **Температура (Фаренхайт):** 32,0 – 176,0 $^{\circ}\text{F}$


Точност:

- $\pm 2\%$ (0 – 2000 ppm)
- $\pm 5\%$ (над 2000 ppm)

Нетно тегло: 55 g

Размери: 154 × 30 × 14 mm

ПРЕГЛЕД НА ПРОДУКТА

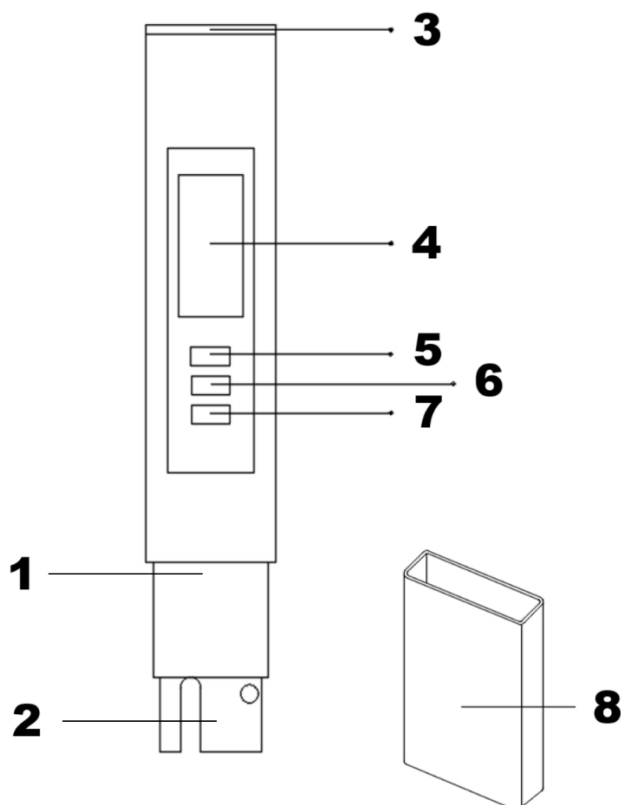

1. Линия на потапяне
2. Високоточен титанов електрод
3. Отделение за батерия
4. LCD дисплей
5. Бутон MODE
6. Бутон CLEAR
7. Бутон ON/OFF/HOLD
8. Защитна капачка

ФУНКЦИИ

Функция Hold

Устройството може да заключи измерената стойност чрез двойно натискане на бутона **HOLD**. Стойността се заключва автоматично и след стабилизиране. В заключен режим режимът може да се смени с бутона **MODE**. За отключване натиснете бутона **CLEAR**.

Автоматично изключване

Устройството се изключва автоматично след 2 минути бездействие за пестене на батерията.

Автоматична температурна компенсация

Устройството е снабдено с функция за автоматична температурна компенсация за по-точни измервания.

Смяна на режим

Чрез бутона **MODE** се превключва между четири режима на показване: ppm, $\mu\text{S}/\text{cm}$, °C, °F.



- TDS < 40 ppm: дисплеят светва в зелено
- TDS $\geq$ 40 ppm: дисплеят светва в червено

Устройството има функция за памет. При включване се връща в последния използван режим преди изключване.

Поддръжка

- Поддържайте електрода чист и винаги го покривайте със защитната капачка.
- Ако устройството няма да се използва дълго време, извадете батериите.

Използване на продукта

1. Преди употреба свалете защитната капачка на електрода.
2. Натиснете бутона **ON/OFF** и потопете тестера в разтвора (не надвишавайте линията на потапяне).
3. След стабилизиране на стойността натиснете бутона **HOLD**, извадете тестера и отчетете резултата.

4. След употреба почистете електрода, изключете тестера и поставете защитната капачка.

Бележки

1. Устройството е предназначено за домашна употреба и не е подходящо за професионални лабораторни приложения.
2. Избягвайте топлина, пряка слънчева светлина и потапяне над линията на потапяне.
3. За калибриране използвайте стандартни буферни разтвори. Неправилното калибриране може да доведе до неточни резултати или повреда на устройството.
4. Устройството **не е водоустойчиво**. Не го потапяйте изцяло и не надвишавайте линията на потапяне, тъй като може да възникне късо съединение.

УКАЗАНИЯ ЗА РЕЦИКЛИРАНЕ И ИЗХВЪРЛЯНЕ:



Тази етикетка означава, че продуктът не може да се изхвърли като обикновен битов отпад в цялата ЕС. За предотвратяване на възможни вреди за околната среда или човешкото здраве от неконтролирано изхвърляне на отпадъци. Рециклирайте отговорно, за да се подпомогне устойчивата употреба на материални ресурси. Ако искате да върнете употребявано устройство, използвайте системата за събиране и събиране или се свържете с търговеца, от когото сте закупили продукта. Търговецът може да приеме продукта за екологично безопасно рециклиране.



Декларация от производителя, че продуктът отговаря на изискванията на съответните директиви на ЕС.